
VERORDNUNGSLEITFADEN UND FAQS ZUM OMNIPOD® 5 AUTOMATISIERTEN† INSULIN-DOSIERUNGSSYSTEM

Omnipod 5 ist kompatibel mit den führenden Sensormarken‡ - Jetzt auch mit FreeStyle Libre 3 Plus

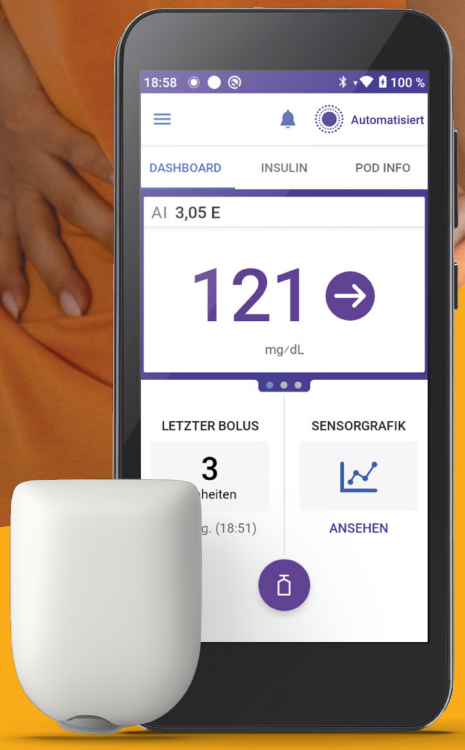

Der Pod ist ohne das erforderliche Pflaster abgebildet.
Die Bildschirmdarstellung dient nur zur Veranschaulichung.

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihren Patient*innen Omnipod 5 zu verschreiben und einen erfolgreichen Start mit der Therapie zu gewährleisten.

omnipod® 5
automated insulin delivery system

†Der Automatisierte Modus erfordert einen kompatiblen Sensor. Kompatible Sensoren werden separat verkauft und verschrieben.
‡Omnipod 5 ist kompatibel mit den Sensoren Dexcom G6, Dexcom G7 sowie FreeStyle Libre 3 Plus. Zusätzlich werden kompatible Pods benötigt.

Rezeptvorlage - Pods bei der Erstversorgung

Für neue Omnipod 5-Anwendende mit Dexcom G7 oder FreeStyle Libre 3 Plus Sensoren (rtCGM)

Bei Erstversorgung mit dem Omnipod 5 System liefert Insulet automatisch das erforderliche Starterset.

1. Angabe von „Omnipod® 5 Pods (Maßeinheit angeben) kompatibel mit (Dexcom G7 oder FreeStyle Libre 3 Plus), Jahresversorgung".
2. Angabe der Hilfsmittelpositionsnummer (optionale Angabe der 7- oder 10-stelligen Positionsnummer).

Hilfsmittelpositionsnummer:

DEXCOM G7 (rtCGM)	
30.29.06.2005 Omnipod 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem (mg/dL) kompatibel mit **Dexcom G7** (rtCGM)	30.29.06.2006 Omnipod 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem (mmol/L) kompatibel mit **Dexcom G7** (rtCGM)

FREESTYLE LIBRE 3 PLUS (rtCGM)	
Positionsnummer folgt Omnipod 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem (mg/dL) kompatibel mit **FreeStyle Libre 3 Plus** (rtCGM)	**Positionsnummer folgt** Omnipod 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem (mmol/L) kompatibel mit **FreeStyle Libre 3 Plus** (rtCGM)

IN KÜRZE AUCH MIT FREESTYLE LIBRE 3 PLUS



Der Pod und die Sensoren sind ohne das erforderliche Pflaster abgebildet.
Die Bildschirmdarstellung dient nur zur Veranschaulichung.

3. Angabe der Diagnose und der Indikation (z. B. Diabetes mellitus Typ 1: ungenügende Einstellung unter ICT)
4. Das Feld Nummer 7 für „**Hilfsmittel**" ankreuzen.

Verordnung

Omnipod 5 kompatibel mit Dexcom G7:

- **Maßeinheit mg/dL:**
  HMV-Nr. 30.29.06.2005
- **Maßeinheit mmol/L:**
  HMV-Nr. 30.29.06.2006

Omnipod 5 kompatibel mit FreeStyle Libre 3 Plus:

- **Maßeinheit mg/dL:**
  HMV-Nr. **folgt**
- **Maßeinheit mmol/L:**
  HMV-Nr. **folgt**

Beispielrezept

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten — geb. am

Kostenträgerkennung | Versicherten-Nr. | Status

Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum

BVG | Hilfsmittel (X) | Impfstoff | Spr.-St. Bedarf | Begr.-Pflicht | Apotheken-Nummer / IK

Zuzahlung | Gesamt-Brutto

Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr. | Faktor | Taxe

1. Verordnung
2. Verordnung
3. Verordnung

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen) — Vertragsarztstempel

1. Omnipod® 5 Pods (Maßeinheit angeben), kompatibel mit (Dexcom G7 oder FreeStyle Libre 3 Plus), Jahresversorgung
2. HMV-Nr. 30.29.06.2
3. Diagnose: Diabetes mellitus Typ-1, (z. B. ungenügende Einstellung unter ICT)

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Abgabedatum in der Apotheke

Unterschrift des Arztes
Muster 16 (10.2014)

Unfalltag | Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

WICHTIGE HINWEISE

- Eine Folgeverordnung sollte mindestens 4 Wochen vor dem Ablaufdatum der aktuellen Verordnung erstellt werden.
- Bei einer Erstversorgung wird zusätzlich zur Verordnung das Omnipod 5-Auftragsformular benötigt.
- Ihr/e Patient*in sendet die oben genannten Dokumente per Freiumschlag an: Insulet Germany GmbH, Postfach 21 05 23, 80675 München.
- Insulet erstellt ggf. einen Kostenvoranschlag und reicht diesen bei der Krankenkasse ein.
- Die Krankenkasse hat in der Regel 28 Tage Zeit, den Kostenvoranschlag zu bearbeiten. Im Falle einer zusätzlichen Prüfung durch den Medizinischen Dienst ist mit einer Verlängerung der Bearbeitungszeit zu rechnen.


omnipod® 5 automated insulin delivery system

Rezeptvorlage - Pods beim Sensorwechsel*


Für bestehende Omnipod 5-Anwendende, die vom Dexcom G6/G7 Sensor (rtCGM) auf den FreeStyle Libre 3 Plus Sensor (rtCGM) wechseln möchten.

In diesem Fall ist ein Rezept für neue Omnipod 5 Pods erforderlich!
Die derzeitigen Dexcom G6-/G7-Pods sind nicht kompatibel mit dem FreeStyle Libre 3 Plus Sensor.

1. Angabe von „Omnipod® 5 Pods (Maßeinheit angeben) kompatibel mit FreeStyle Libre 3 Plus, und Zeitraum der Versorgung, z. B. Jahresversorgung“.
2. Angabe der Hilfsmittelnummer + **Hinweis auf den Sensorwechsel** (Angabe der 7-stelligen Positionsnummer).
3. Angabe der **Diagnose** Diabetes mellitus Typ-1.
4. Das Feld Nummer 7 für „**Hilfsmittel**“ ankreuzen.

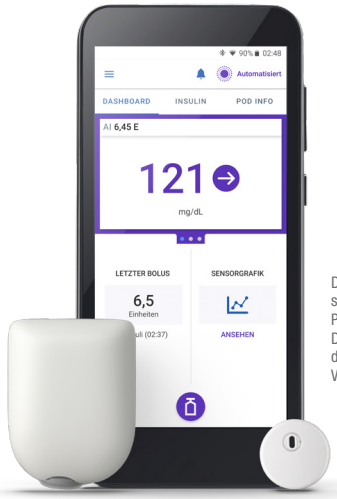

Der Pod und die Sensoren sind ohne das erforderliche Pflaster abgebildet. Die Bildschirmdarstellung dient nur zur Veranschaulichung.

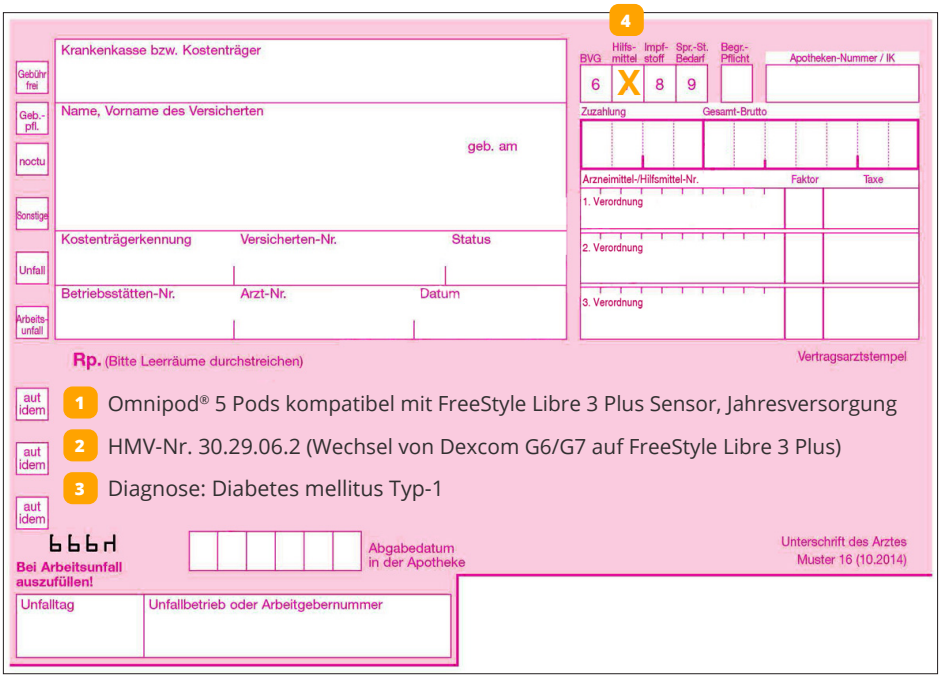

WICHTIGE HINWEISE

- Verordnungen müssen separat bei Insulet (für die neuen Pods) und Abbott Diabetes Care (Sensoren) eingereicht werden.
- Ihre Patientin/Ihr Patient sendet die Wechsel-Verordnung an: Insulet Germany GmbH, Postfach 21 05 23, 80675 München.
- Bestehende Omnipod 5-Anwendende sollten alle vorhandenen Dexcom-kompatiblen Pods aufbrauchen, bevor sie auf den neuen FreeStyle Libre 3 Plus Sensor umsteigen.
- Regulär werden neue Omnipod 5 Pods mit FreeStyle Libre 3 Plus-Konnektivität mit der nächsten Lieferung gemäß dem bestehenden Lieferplan versendet.
- Für Unterstützung bei der Koordination der Lieferungen wenden sich Ihre Patient*innen bitte an den Kundenservice von Insulet: 0800 1821 629.
- Die Patientin bzw. der Patient muss die neueste Softwareversion auf dem vorhandenen Steuergerät installieren, um den neuen FreeStyle Libre 3 Plus Sensor verbinden zu können.
- Nach dem Sensorwechsel ist seitens Insulet keine zusätzliche Schulung erforderlich.
- Eine Folgeverordnung sollte mindestens 4 Wochen vor dem Ablaufdatum der aktuellen Verordnung erstellt werden.

*Die mit dieser Rezeptvorlage bereitgestellten Informationen gelten in gleicher Weise für alle Sensorwechsel zwischen den mit Omnipod 5 verwendbaren rtCGM-Sensoren.

omnipod® 5 automated insulin delivery system



FAQs
für den Wechsel auf den FreeStyle Libre 3 Plus-Sensor:

1 Muss ich neue Omnipod 5-Pods verschreiben für die Integration des FreeStyle Libre 3 Plus-Sensors?

Ja. Die Integration von Omnipod 5 mit dem FreeStyle Libre 3 Plus-Sensor erfordert neue, kompatible Pods. Der FreeStyle Libre 3 Plus-Sensor wird separat verkauft und verschrieben.

2 Benötigen Patinet*innen für die Nutzung des FreeStyle Libre 3 Plus-Sensors ein neues Omnipod® 5-Steuergerät?

Nein. Die Integration des FreeStyle Libre 3 Plus-Sensors wird durch die Softwareversion [4.0.3] ermöglicht, die für alle Omnipod 5-Steuergeräte über ein Update zur Verfügung steht. Zusätzlich benötigen Ihre Patient*innen die neuen Pods, die mit dem FreeStyle Libre 3 Plus-Sensor kompatibel sind, um das Omnipod 5-System mit dem FreeStyle Libre 3 Plus-Sensor im Automatisierten Modus verwenden zu können.

3 Was muss bei einem Wechsel von Dexcom G6/G7 zu FreeStyle Libre 3 Plus in Verbindung mit der Verwendung des Omnipod 5-Systems beachtet werden?

Es werden neue Verordnungen für kompatible Omnipod 5-Pods und den FreeStyle Libre 3 Plus Sensor benötigt. Diese müssen separat bei Insulet (Pods) und Abbott Diabetes Care (Sensoren) eingereicht werden. Vorhandene Dexcom-kompatible Pods müssen zuvor aufgebraucht werden.

4 Wie kann man feststellen, ob die Omnipod 5-Pods mit dem FreeStyle Libre 3 Plus-Sensor kompatibel sind?

Die neuen Omnipod 5-Pods, die mit dem FreeStyle Libre 3 Plus-Sensor kompatibel sind, weisen oben rechts auf dem Karton sowie auf der Verpackung des einzelnen Pods darauf hin. Die mit Dexcom G6 und G7 kompatiblen Omnipod 5-Pods sind nicht mit dem FreeStyle Libre 3 Plus-Sensor kompatibel. Eine visuelle Anleitung, wie Sie anhand der Verpackung Sie die neuen Pods erkennen können, finden unter https://www.omnipod.com/de-de/sensorwechsel.

5 Der FreeStyle Libre 3 Plus-Sensor sendet jede Minute einen Glukosewert an das Omnipod 5-System. Erhalten Patinet*innen jede Minute einen neuen Messwert?

Das Omnipod 5-Steuergerät zeigt alle 5 Minuten Glukose-Messwerte an. Dies wird auch mit dieser Integration so bleiben. Die 1-Minuten-Glukosedaten werden zwar nicht angezeigt, es gibt jedoch eine Ausnahme: Wenn ein 5-Minuten-Messwert verpasst wird und im folgenden Zyklus ein 1-Minuten-Sensor-Wert verfügbar ist, zeigt die App den 1-Minuten-Wert an, um die Kontinuität der Glukosedaten sicherzustellen.

Mehr Infos zum Thema Verordnung auf unserer Website

omnipod 5 automated insulin delivery system

†Der Automatisierte Modus erfordert einen kompatiblen Sensor. Kompatible Sensoren werden separat verkauft und verschrieben.

‡Omnipod 5 ist kompatibel mit den Sensoren Dexcom G6, Dexcom G7 sowie FreeStyle Libre 3 Plus. Zusätzlich werden kompatible Pods benötigt.

Das Omnipod 5 Automatisierte Insulin-Dosierungssystem ist ein Ein-Hormon-Insulindosierungssystem zur subkutanen Verabreichung von U-100-Insulin zur Behandlung von Typ-1-Diabetes bei Personen ab 2 Jahren, die Insulin benötigen. Das Omnipod 5-System ist für die Verwendung durch eien einzelnen Patienten vorgesehen. Das Omnipod 5-System ist für die Verwendung mit U-100-Insulin indiziert. Vollständige Sicherheitsinformationen, einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen, finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Omnipod® 5 Systems und unter www.omnipod.com/sscp.

©2026 Insulet Corporation. Omnipod und das Omnipod-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Insulet Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dexcom, Dexcom G6 und Dexcom G7 sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Dexcom, Inc. und werden mit Genehmigung verwendet. Libre, das Schmetterlingslogo, die Form und das Erscheinungsbild des Sensors, die Farbe Gelb sowie sämtliche damit zusammenhängende Marken und/oder Designs sind das geistige Eigentum der Abbott Unternehmensgruppe in ausgewählten Ländern und werden mit Genehmigung verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung von Marken Dritter stellt keine Befürwortung dar und impliziert weder eine Beziehung noch eine sonstige Zugehörigkeit. Insulet Germany GmbH, Landsberger Straße 302, 80687 München, Deutschland. INS-OHS-07-2026-00306 v1.0